

精度管理

〈施設認証関連〉

	取得年度／有効期間	参考資料
ISO15189 認証取得	2028.1.31 (有効期限)	認定証
日本臨床衛生検査技師会臨床検査精度管理調査	2025.8.27	参加証
日本医師会臨床検査精度管理調査	2026.2.16	参加証
広島県医師会臨床検査精度管理調査	2025.11	参加証


〈臨床検査基準値〉

臨床検査基準値

〈測定機器の精度管理リスト〉


番号		精度管理対象	最終点検日
1	外来	血圧計 (内科外来受付前①)	2025.10.9
2		小児用血圧計 (治験管理室)	2025.12.1
3		身長計	日常点検
4		体重計	1回/2年
5	治験管理室	治験管理室検体保管用ディープフリーザー	2026.3.18
6		治験管理室検体保管用冷蔵庫	2025.8.13
7		治験管理室検体保管用冷凍庫	2025.8.13
8	薬剤部	治験薬保管庫	
9		最高/最低温度アラーム付きデジタル温度計 (恒温槽)	2025.4.8
10		最高/最低温度アラーム付きデジタル温度計 (室温)	2025.4.8
11		最高/最低温度アラーム付きデジタル温度計 (冷所)	2025.4.8
12	臨床検査科	心電計	2025.12.10
13		冷却遠心機	2026.2.5

証明書等をご入用の方は治験管理室までお問い合わせ下さい。

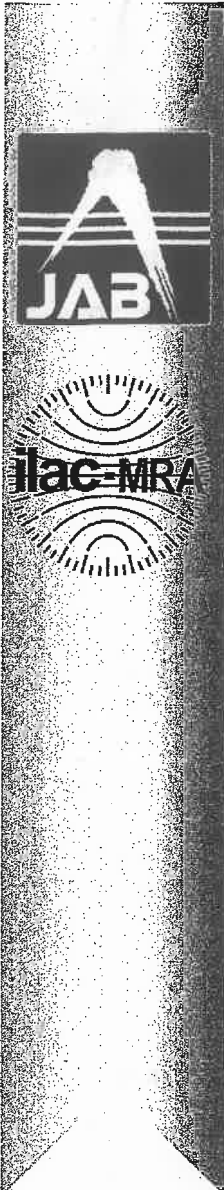

臨床検査室 認定証

認定番号 RML02170

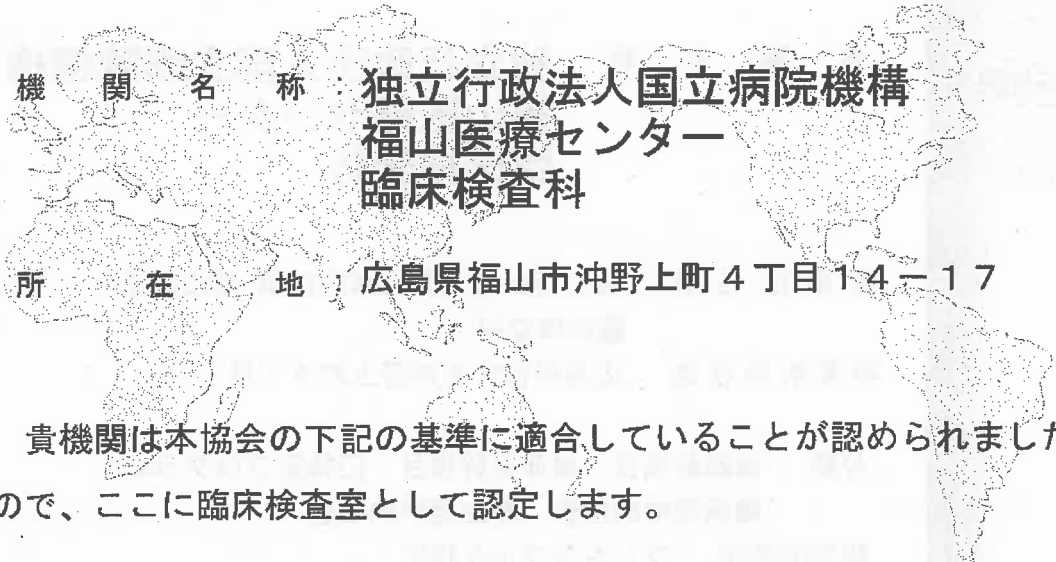

機 関 名 称 : 独立行政法人国立病院機構
福山医療センター
臨床検査科

所 在 地 : 広島県福山市沖野上町4丁目14-17

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに臨床検査室として認定します。

- 適 用 基 準 : ISO 15189 : 2022 (英和対訳版)
- 認 定 範 囲 : 附属書による。
- 事 業 所 : 附属書による。
- 有 効 期 限 : 2028年1月31日

改定日 2025年2月1日
 更新日 2024年2月1日
 初回認定日 2020年1月24日

公益財団法人
日本適合性認定協会

理事長


 三木 幸信

参加証

独立行政法人 国立病院機構

福山医療センター 殿

貴施設は日本臨床衛生検査技師会
臨床検査精度管理調査（2025年度）
に参加したことを証します。

令和7年8月27日

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

代表理事 会長 横地 常





3450001

証


独立行政法人国立病院機構
福山医療センター 殿

令和7年度（第59回）日本医師会臨床検査精度管理調査に参加したことを証します

2026年2月16日

公益社団法人 日本医師会

会長 松本吉郎



参加証明書

独立行政法人 国立病院機構

福山医療センター 殿

令和7年度（第53回）広島県臨床検査精度管理
調査に参加されたことを証明します

2025(令和7)年11月

一般社団法人広島県医師会

会長 松村

